

**DS WIN**

# **UPDATE AKTUELL**

## **4/2025**

Stand: November 2025

### **Pflicht- update**

Bitte spätestens vor  
dem ersten Arbeitstag  
im Januar einlesen

Sehr geehrtes Praxis-Team,

pünktlich zum Ende dieses Quartals stellen wir Ihnen die aktualisierte Version des DS-Win zur Verfügung. Wir arbeiten für Sie kontinuierlich an der Optimierung unserer Produkte, sodass wir auch in diesem Quartal praxisnahe Verbesserungen realisiert haben.

So erhalten Sie mit diesem Update eine Hinweismeldung, wenn Sie die BEMA-Leistungen 107 (Zst), 107a (PBZst) und 04 (PSI) nach einer PAR-Behandlung abrechnen wollen, da dies gemäß der Abrechnungsbestimmungen nicht vorgesehen ist und Sie können PAR-Befunde nun mit den jeweiligen befundbezogenen Messwerten drucken.

Das General-Update 4/2025 enthält zudem neue Prüfmodule. Die Installation der Module ist Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf bei den Abrechnungen. Bitte lesen Sie es daher vor Ihrem ersten Arbeitstag im Januar 2026 ein.

Diese und weitere Inhalte des General-Updates stellen wir Ihnen auch in unserem kostenfreien Webinar „Neues im General-Update“ vor. Melden Sie sich gleich an: <https://www.dampsoft.de/webinare/>

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen Update Aktuell.

Ihr Dampsoft-Team

## Die wichtigsten Änderungen 1/2

### Neue Prüfmodule

Wir liefern Ihnen wie in jedem Quartal die aktuell gültigen Prüfmodule für die einzelnen Abrechnungen mit aus. Nur wenn Sie die neuen Prüfmodule eingelesen haben, können Sie Ihre Abrechnungen korrekt durchführen.

Seite 5

### PAR: Abrechnungshinweis „PSI“ und „Zst“

Sie erhalten zukünftig eine Hinweismeldung, wenn Sie die BEMA-Leistungen 107 (Zst), 107a (PBZst) und 04 (PSI) nach einer PAR-Behandlung abrechnen wollen, da dies gemäß der Abrechnungsbestimmungen nicht vorgesehen ist.

Seite 10

### PAR: Befunde mit Messwerten drucken

PAR-Befunde können ab sofort mit den jeweiligen befundbezogenen Messwerten gedruckt werden.

Seite 10

### DZR-Abrechnungsbüro: Ankaufanfragen für alle Patienten aktualisieren

Mit diesem Update erhalten Praxen, die mit dem DZR arbeiten, eine neue Schaltfläche. Mit dieser können offene Ankaufanfragen der letzten 4 Wochen für die aktuelle Praxis aktualisiert werden.

Seite 17

## Die wichtigsten Änderungen 2/2

### Dr. Flex: Neue Voreinstellung für Benachrichtigungsstatus

Der Dialog „Voreinstellungen für Recall“ wurde um eine neue Voreinstellung erweitert, durch die der Benachrichtigungsstatus automatisch gesetzt wird, sobald ein Termin mit Dr. Flex im Terminbuch gebucht wird.

Seite 24

<b>1.</b>	<b>Gesetzliche / technische Änderungen</b>	5
1.1	Prüfmodule	<b>WICHTIG</b> 5
1.2	Update für DS-Server verfügbar	6
1.3	Dampsoft-Webshop aus dem DS-Win aufrufen	7
1.4	Neuer Dialog für tagesaktuelle Ereignisse	7
1.5	Neue BEMA-Leistungen für Früherkennungsuntersuchungen	9
<b>2.</b>	<b>Patient</b>	10
2.1	PAR: Abrechnungshinweis „PSI“ und „Zst“	<b>WICHTIG</b> 10
2.2	PAR: Befunde mit Messwerten drucken	<b>WICHTIG</b> 10
2.3	Patientenauswahl: Neues Feld im Reiter „Bank“	11
<b>3.</b>	<b>Formulare</b>	12
3.1	Neues Formular: „Unerwünschte Wirkungen und Mängel von Medizinprodukten“	12
3.2	Abrechnungsbüro: EVE für PVS Reiss GmbH aktualisiert	12
3.3	Abrechnungsbüro: EVE für PVS dental aktualisiert	14
3.4	Abrechnungsbüro: EVE für Goya Health aktualisiert	15
3.5	DZR-Abrechnungsbüro: Ankaufanfragen für alle Patienten aktualisieren	<b>WICHTIG</b> 17
<b>4.</b>	<b>e-health</b>	20
4.1	Allgemeine Informationen zu e-health	20
4.2	KIM: Große KIM-Mails im Hintergrund senden	21
<b>5.</b>	<b>Erweiterungen</b>	22
5.1	DS-Win-BuS/MPG: Neues Siegelgerät MELAG „MELAseal300“ einbinden	22
5.2	DS-Win-BuS/MPG: Neuen Sterilisator MELAG „MELAtherm 20“ einbinden	23
5.3	Dr. Flex: Neue Voreinstellung für Benachrichtigungsstatus	<b>WICHTIG</b> 24
5.4	DS-Win-MED: Neues Kodierungssystem für Gendiagnostik	25
5.5	Athena: Datum der Einverständniserklärungen wird übernommen	25

# 1. Gesetzliche / technische Änderungen

## 1.1 Prüfmodule


Damit Sie Ihre Abrechnungen korrekt einreichen können, liefern wir Ihnen wie in jedem Quartal die aktuell gültigen Prüfmodule für die einzelnen Abrechnungen mit aus.

Hier erhalten Sie eine Übersicht der aktuell gültigen Prüfmodule:

Die Prüfmodule folgen.

Diese Anpassung erfolgt automatisch mit dem Update — Sie müssen dafür nichts weiter tun.

**Tipp:** Im DS-Win erhalten Sie jederzeit eine praktische Übersicht der aktuell enthaltenen Prüfmodule. Aktuelle Prüfmodule werden angezeigt, sobald diese gültig sind. Die Prüfmodule finden Sie im Hauptmenü unter „Abrechnung/Info“ oder über die Funktionstaste F9 auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf die >>Abrechnungsinfo<< ①.

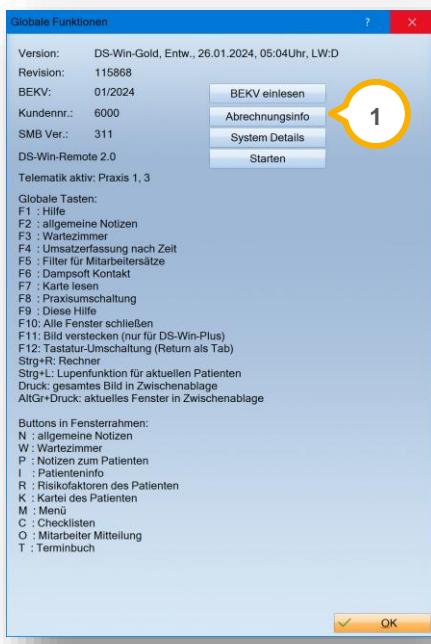

## 1.2 Update für DS-Server verfügbar

Für den DS-Server, der mit Athena oder der Schnittstelle für Verordnungssoftware verwendet wird, steht ein neues Sicherheits-Update der Serversoftware auf die Version „Apache/2.4.63 (Win64) OpenSSL/3.3.2“ zur Verfügung.

Um das Update durchzuführen, ist es notwendig, den DS-Server neu einzurichten. Für die Neueinrichtung ist der DS-Server zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren.

### Hinweis!

Wenden Sie sich für die Neueinrichtung an Ihren Systembetreuer.

Ob in Ihrer Praxis der DS-Server eingerichtet ist, erkennen Sie anhand der Symbolleiste für den Schnellzugriff im Bereich ①. Wenn der DS-Server mit Athena eingerichtet ist, wird zusätzlich ein „A“ angezeigt.



Um bei Bedarf die aktuelle Version der Serversoftware und die DS-Server-Adresse anzuzeigen, klicken Sie auf das DS-Server-Symbol im Bereich ①.

Die Hinweise zum Vorgehen kann Ihr Systembetreuer in den jeweiligen Beschreibungen zu der Einrichtung auf der Dampsoft-Website im Bereich „Service/Infos für Systembetreuer“ finden.

Anleitung zur Deinstallation und Installation für den DS-Server mit Athena:


<https://hilfe.athenaapp.de/docs/athena-installation>

Anleitung zur Deinstallation und Installation ohne Athena:

<https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2020/11/Installation-DS-Server-ohne-Athena.pdf>

## 1.3 Dampsoft-Webshop aus dem DS-Win aufrufen

Mit diesem Update erhalten Sie die Möglichkeit, den Webshop von Dampsoft direkt aus dem DS-Win zu öffnen.

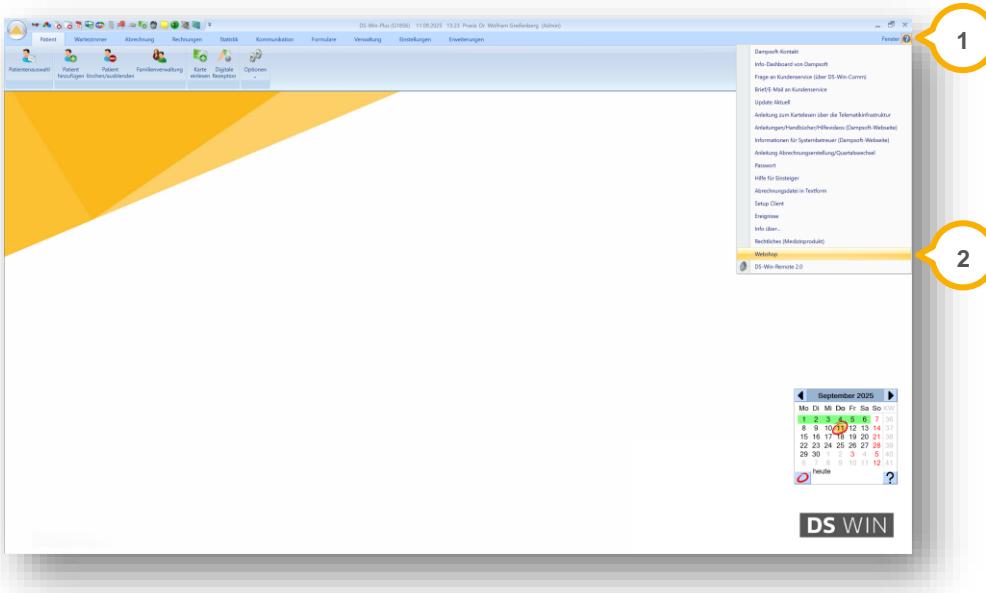

Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol ①.

Wählen Sie aus der Auswahlliste „Webshop“ ②.

Der Webshop wird in Ihrem Standard-Browser geöffnet.

## 1.4 Neuer Dialog für tagesaktuelle Ereignisse


Mit diesem Update wurde ein neuer Dialog eingeführt, der tagesaktuelle Informationen zu Hintergrundprozessen sammelt und übersichtlich darstellt.

Über den Dialog werden bereits Ereignisse im Zusammenhang mit der Online-Terminvergabe Dr. Flex angezeigt. In Zukunft wird dieser Bereich schrittweise um weitere Ereignistypen erweitert.

Um den Dialog zu öffnen, klicken Sie auf das neue Symbol ①.



Wenn ein neues Ereignis vorliegt, wird in dem Symbol ein Ausrufezeichen angezeigt.

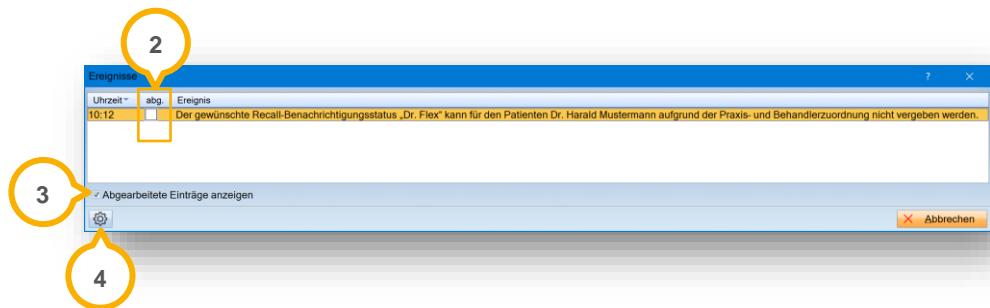


Um Ereignisse als abgearbeitet zu kennzeichnen, setzen Sie ein Häkchen bei „abg.“ **(2)**.

Um abgearbeitete Ereignisse anzeigen zu lassen, setzen Sie die Auswahl bei „Abgearbeitete Einträge anzeigen“ **(3)**.

Sie können den Dialog für jedes neue Ereignis anzeigen lassen.

Klicken Sie dazu auf das Einstellungssymbol **(4)**.

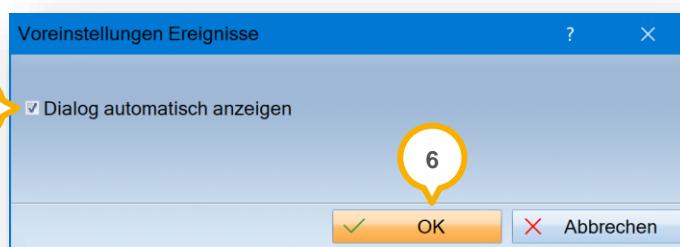

Setzen Sie die Auswahl bei „Dialog automatisch anzeigen“ **(5)**.

Übernehmen Sie die Änderungen mit >>OK<< **(6)**.

## 1.5 Neue BEMA-Leistungen für Früherkennungsuntersuchungen

Ab dem **1. Januar 2026** treten in der BEMA neue Gebührennummern für die Früherkennungsuntersuchungen (FU) bei Kindern in Kraft.

Mit der Installation dieses Updates werden die neuen Leistungen automatisch in Ihrem BEMA-Leistungsverzeichnis ergänzt.

### **Hinweis!**

**Beachten Sie, dass die neuen Leistungen erst ab dem 1. Januar 2026 abgerechnet werden können.  
Verwenden Sie bis dahin die derzeit gültigen Gebührennummern.**

Die Gebührennummer **FU1** wird wie folgt angepasst:

- FUZ1: Früherkennungsuntersuchung vom 6. bis zum vollendeten 9. Lebensmonat
- FUZ2: Früherkennungsuntersuchung vom 10. bis zum vollendeten 20. Lebensmonat
- FUZ3: Früherkennungsuntersuchung vom 21. bis zum vollendeten 33. Lebensmonat

Die Gebührennummer **FU2** wird wie folgt angepasst:

- FUZ4: Früherkennungsuntersuchung vom 34. bis zum vollendeten 48. Lebensmonat
- FUZ5: Früherkennungsuntersuchung vom 49. bis zum vollendeten 60. Lebensmonat
- FUZ6: Früherkennungsuntersuchung vom 61. bis zum vollendeten 72. Lebensmonat

## 2. Patient

### 2.1 PAR: Abrechnungshinweis „PSI“ und „Zst“

Die Abrechnung der folgenden BEMA-Leistungen ist gemäß der Abrechnungsbestimmungen während oder unmittelbar nach einer PAR-Behandlung nicht vorgesehen:

- 107 (Zst)
- 107a (PBZst)
- 04 (PSI)


**Tipp:** Wenn Sie versuchen, eine BEMA-Leistung innerhalb eines unzulässigen Zeitraumes abzurechnen, erhalten Sie im DS-Win eine Hinweismeldung.

### 2.2 PAR: Befunde mit Messwerten drucken

PAR-Befunde können ab sofort mit den jeweiligen befundbezogenen Messwerten gedruckt werden.

**Tipp:** Diese Auswahl steht für alle Befunde zur Verfügung. Im Reiter „UPT-Verlängerung“ ist die Auswahl inaktiv.

Öffnen Sie einen Patienten und wechseln Sie in den Reiter „PAR“ ①.

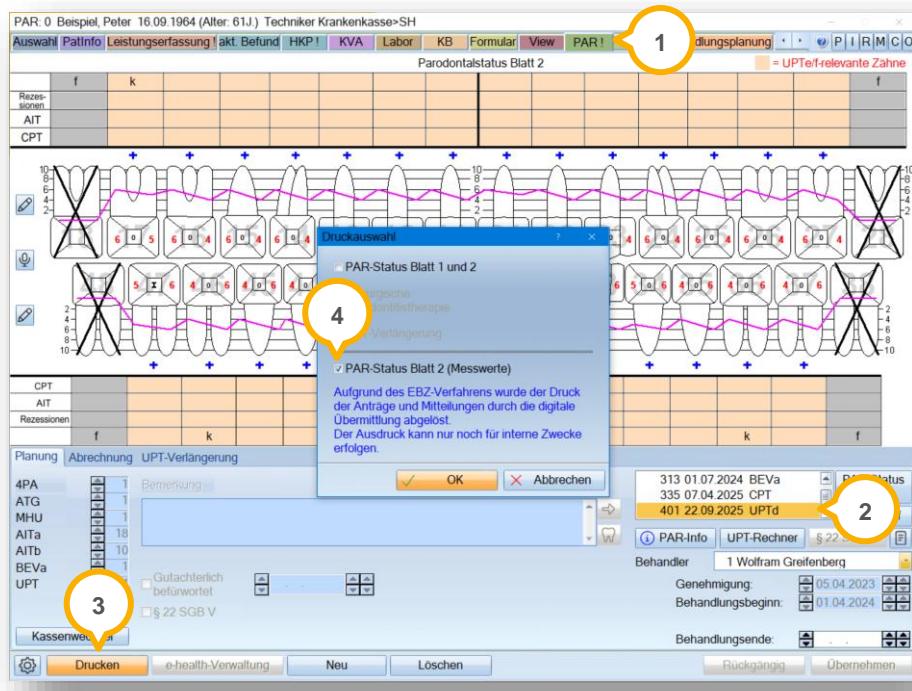

Wählen Sie den gewünschten Befund ② aus. Klicken Sie auf >>Drucken<< ③.

Stellen Sie sicher, dass die Auswahl bei „PAR-Status Blatt 2 (Messwerte)“ ④ gesetzt ist.

**Tipp:** Wenn ein AIT- oder CPT-Befund ausgewählt ist, aber nur Messwerte gedruckt werden sollen, setzen Sie die Auswahl. Bei anderen Folgebefunden (BEVa, BEVb, UPTd, UPTg) ist die Auswahl automatisch gesetzt.

Die befundbezogenen Messwerte werden gedruckt.


## 2.3 Patientenauswahl: Neues Feld im Reiter „Bank“

Im Zuge der neuen EU-Verordnung *Verification of Payee (VoP)* wurde der Reiter „Bank“ in der Patientenauswahl überarbeitet und ein neues Feld ergänzt. Die Anpassung ermöglicht es, den Namen des Kontoinhabers vollständig zu hinterlegen.

### Hinweis!

Das neue Feld „Name Kontoinhaber“ ist auf 70 Zeichen begrenzt. Bereits vor dem Update erfasste Kontodaten bleiben unverändert erhalten. Der zuvor im Feld „Vorname“ hinterlegte Buchstabe wird automatisch in das neue Feld „Name Kontoinhaber“ übernommen.

Um die Daten des Kontoinhabers zu hinterlegen, öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

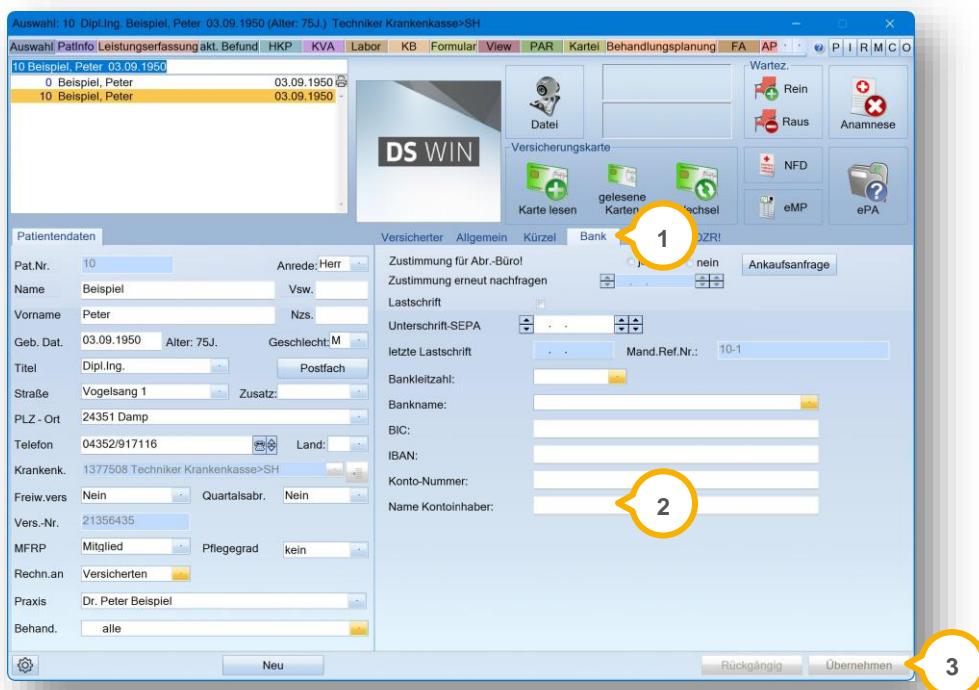

Wechseln Sie in den Reiter „Bank“ **1**.

Hinterlegen Sie die Bankdaten des Patienten im neuen Feld „Name Kontoinhaber“ **2**.

Speichern Sie die Angaben mit >>Übernehmen<< **3**.

### 3. Formulare

#### 3.1 Neues Formular: „Unerwünschte Wirkungen und Mängel von Medizinprodukten“

Das neue Formular „Unerwünschte Wirkungen und Mängel von Medizinprodukten“ wurde hinzugefügt.

**Tipp:** Ab sofort können Sie das Formular via KIM an die Arzneimittelkommission (AKZ) versenden.

##### Hinweis!

Damit alle praxisbezogenen Daten automatisch ausgefüllt werden können, ist die Praxisbezeichnung (Stempel e-health) erforderlich. Diese können Sie bei Bedarf unter „Verwaltung/Praxis/Praxisdaten“ nachtragen.

Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

Wechseln Sie in den Reiter „Formular“ ①.



Klicken Sie auf >>Mängel von Medizinprodukten<< ②.


Das Formular wird geöffnet.

#### 3.2 Abrechnungsbüro: EVE für PVS Reiss GmbH aktualisiert

Die Einverständniserklärung für die PVS Reiss GmbH wurde aktualisiert.

Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

Wechseln Sie in den Reiter „Formular“ ①.

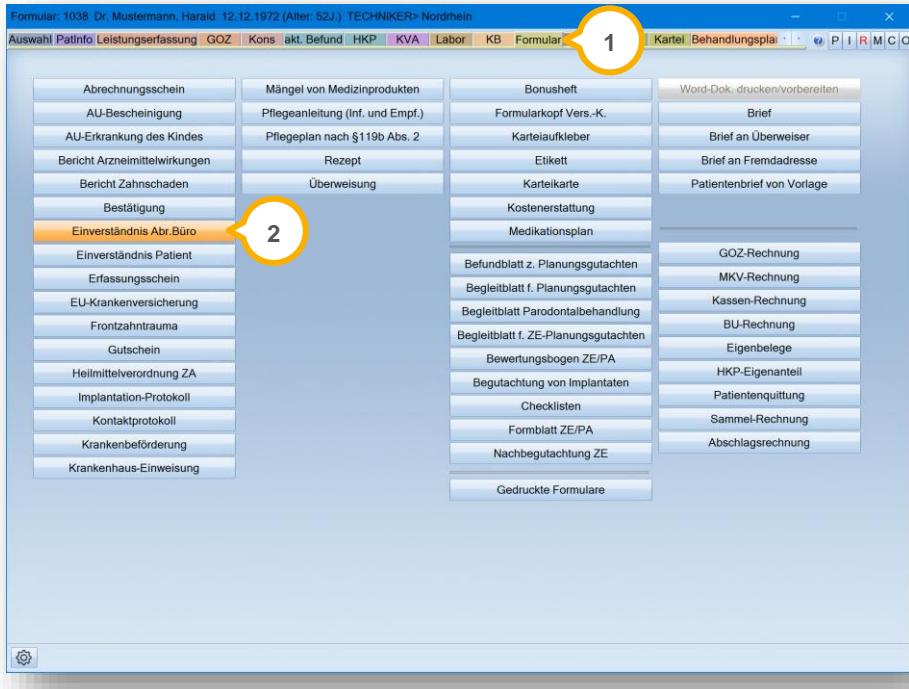

Klicken Sie auf >>Einverständnis Abr. Büro<< ②.

**Information zur Abrechnung  
Einwilligungserklärung**

**pvs>>reiss**

Praxis Mustermann  
Vogelsang 1  
24351 Damp

Praxistempel

PVS Reiss GmbH  
Strandbadstr. 8; 78315 Radolfzell am Bodensee  
Tel. 07732-94 05 0  
Fax 07732-94 05 299  
kontakt@pvs-reiss.de www.pvs-reiss.de

A1

Wählen Sie aus der Auswahlliste ③ die Option „PVS Reiss (2025)“.

### 3.3 Abrechnungsbüro: EVE für PVS dental aktualisiert

Die folgenden Einverständniserklärungen für die PVS dental wurden aktualisiert:


- Einwilligungserklärung unechtes Factoring: PVS dental Version 3
- Einwilligungserklärung echtes Factoring: PVS dental (Factoring) Version 4

Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

Wechseln Sie in den Reiter „Formular“ ①.



Klicken Sie auf >>Einverständnis Abr. Büro<< ②.

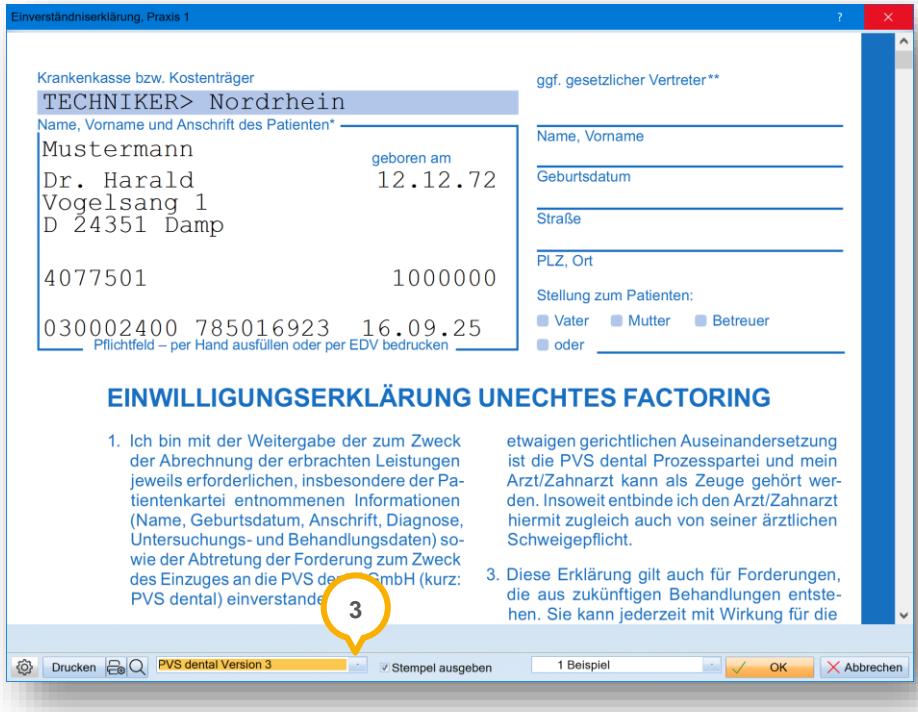


Wählen Sie aus der Auswahlliste ③ die Option „PVS dental Version 3“ bzw. „PVS dental (Factoring) Version 4“.

### 3.4 Abrechnungsbüro: EVE für Goya Health aktualisiert

Die Einverständniserklärung für Goya Health wurde aktualisiert.

Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

Wechseln Sie in den Reiter „Formular“ ①.

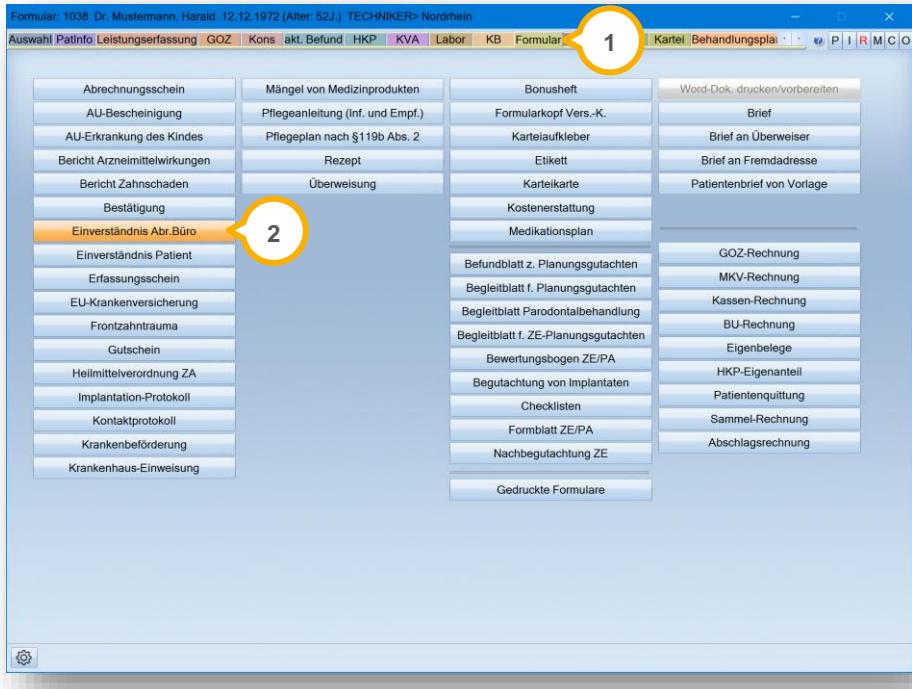

Klicken Sie auf >>Einverständnis Abr. Büro<< (2).

**Einverständniserklärung, Praxis**

**Einwilligungserklärung in Bezug auf abgetretene Vergütungsforderungen** V 29.09.2025

**Goya** GOYA HEALTH

Die Goya Finance AG, An der Eselshaut 2, 67435 Neustadt an der Weinstraße, [www.goyahealth.de](http://www.goyahealth.de) (im Folgenden „Goya“ genannt) übernimmt für unsere Praxis (im Folgenden „Behandler“ genannt) die Abrechnung der für Sie erbrachten Leistungen. Dazu treten wir unsere Forderungen, die gegen Sie aus dem Behandlungsvertrag erwachsen, an Goya ab und übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Goya, damit Goya diese Daten verarbeiten kann. **Mit Ihrer Unterschrift unter die folgende Einwilligungserklärung willigen Sie in die Übermittlung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu dem vorgenannten und im Folgenden weiter konkretisierten Zweck ein.**

Anrede:  Frau  Herr  divers

Titel: Dr.

Vor-/Nachname: Harald Mustermann

Telefon: 04352-917116

Birthdate: 12.12.72

ggf. gesetzlicher Vertreter:

Straße: Vogelsang 1  
PLZ: 24351  
Ort: Damp  
Land: Deutschland

\*Unterzeichnet bei minderjährigen Kindern ein Elternteil allein, erklärt er ausdrücklich, dass die Einwilligung des anderen Sorgerechtigten ebenfalls vorliegt.

1) Hiermit willige ich in die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an Goya sowie in die Verarbeitung dieser Daten durch Goya ein, soweit dies im Zusammenhang mit der/den Abtreten(en) und der Abrechnung der für mich erbrachten oder zu erbringenden medizinischen Leistungen und die Geltendmachung der daraus entstehenden Forderungen erforderlich ist.  
2) Mir ist bewusst, dass Goya die Leistungen eines Arztes

61-63, 60235 Frankfurt einschließlich der Übermittlung der personenbezogenen Daten und Behandlungsdaten/Rechnungsdaten, soweit dies zu den weiteren möglichen Abtretenen und zum Zwecke des Forderungseinzugs und der Refinanzierung des Goya-Geschäftsmodells erforderlich ist:  
e) Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch Goya, die benannten Auskunfteien, die weiteren Goya-

3

Auftrag GOYA HEALTH Stempel ausgeben 1 Beispiel OK Abbrechen

Wählen Sie aus der Auswahlliste (3) die Option „GOYA HEALTH“.


### 3.5 DZR-Abrechnungsbüro: Ankaufanfragen für alle Patienten aktualisieren

Mit diesem Update erhalten Praxen, die mit dem DZR arbeiten, eine neue Schaltfläche. Mit dieser können offene Ankaufanfragen der letzten 4 Wochen für die aktuelle Praxis aktualisiert werden.


Sie können weiterhin, wie gewohnt, einzelne Ankaufanfragen aktualisieren.

#### Voreinstellung: Schaltfläche aktivieren

Folgen Sie dem Pfad „Abrechnung/Abrechnungsbüro“ und öffnen Sie die Einstellungen.

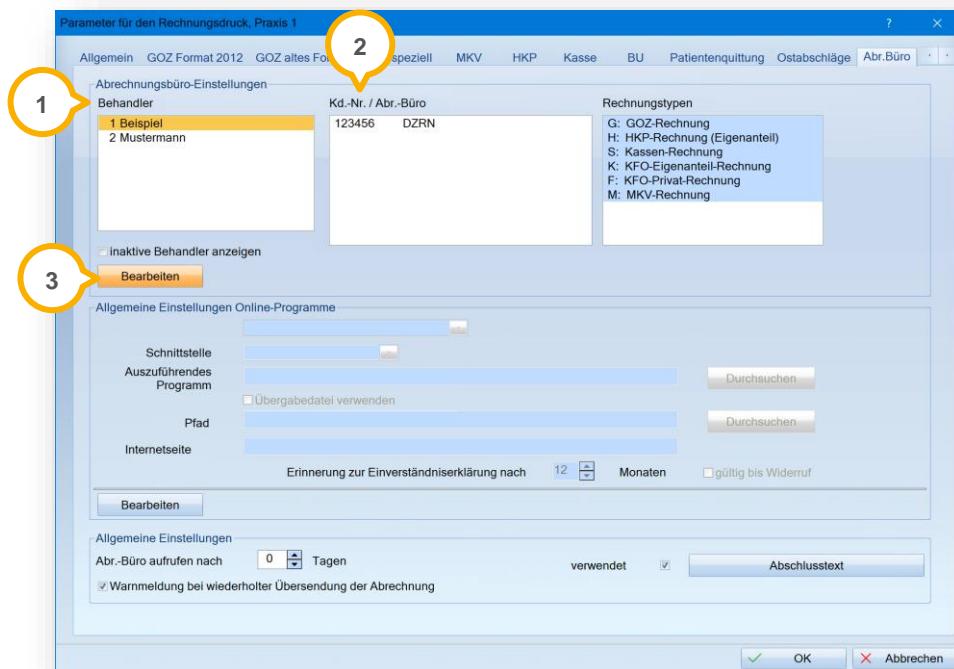


Wählen Sie den Behandler ① und die Kundennummer ②. Klicken Sie auf >>Bearbeiten<< ③.

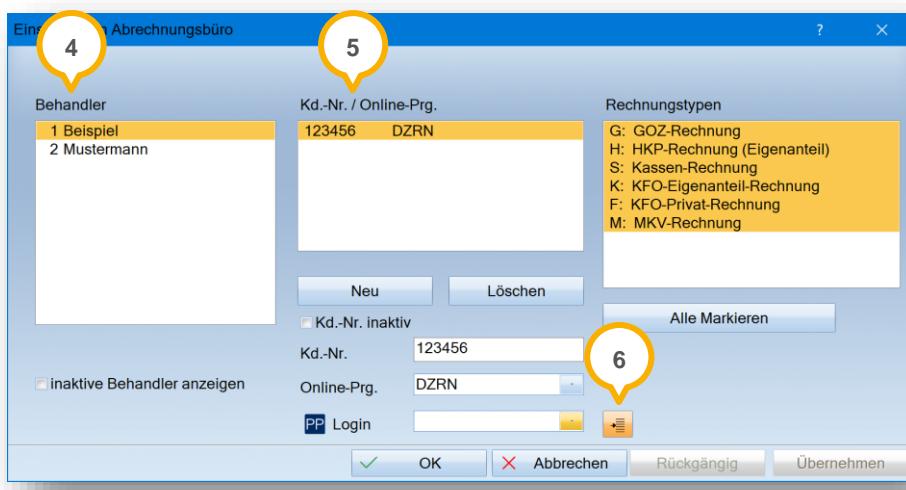

Wählen Sie den Behandler **4** und die Kundennummer **5**.


Klicken Sie auf die Schaltfläche **6**.

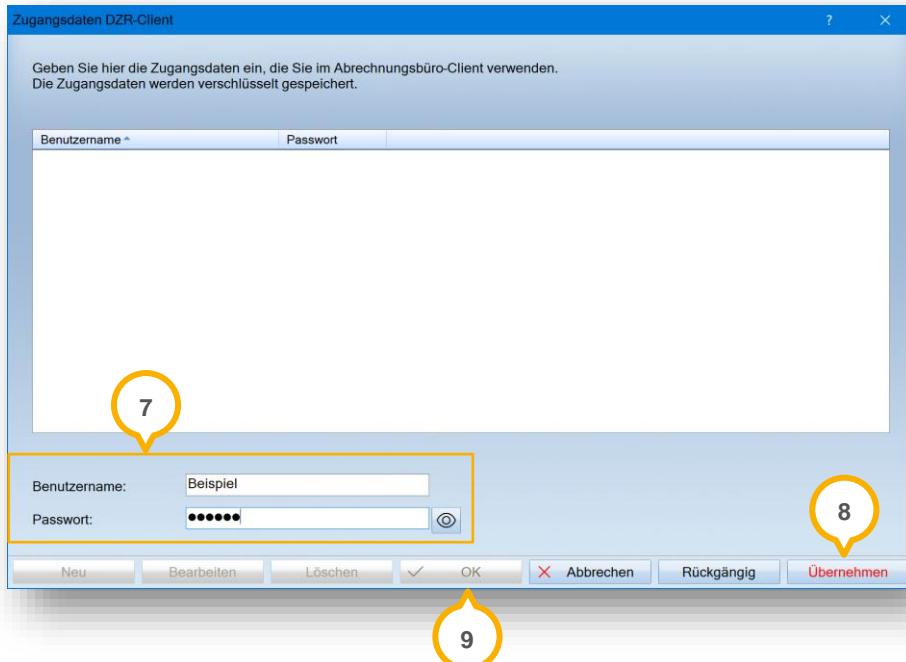

Geben Sie Benutzername und Passwort **7** aus dem Praxisportal-Client ein.

Bestätigen Sie die Eingabe mit >>Übernehmen<< **8**.

Schließen Sie den Dialog mit >>OK<< **9**.

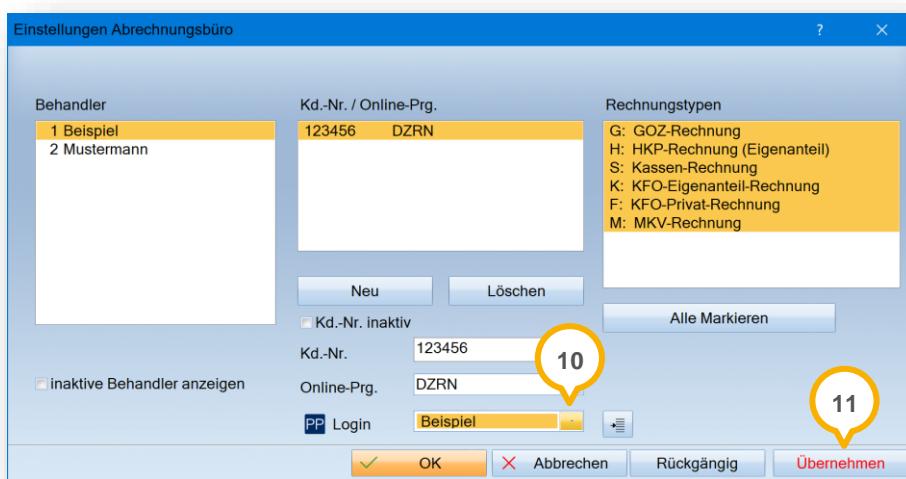


Wählen Sie aus der Auswahliste **10** „PP Login“ die passenden Login-Daten aus.

Bestätigen Sie die Eingabe mit >>Übernehmen<< ⑪.

Es wird eine Prüfung der Login-Daten durchgeführt.

### Ankaufanfragen für alle Patienten aktualisieren

Nachdem die Voreinstellungen hinterlegt sind, wird in der Patientenauswahl im Reiter „DZR“ die Schaltfläche >>Ankaufanfragen für alle Patienten aktualisieren<< ⑫ aktiv.

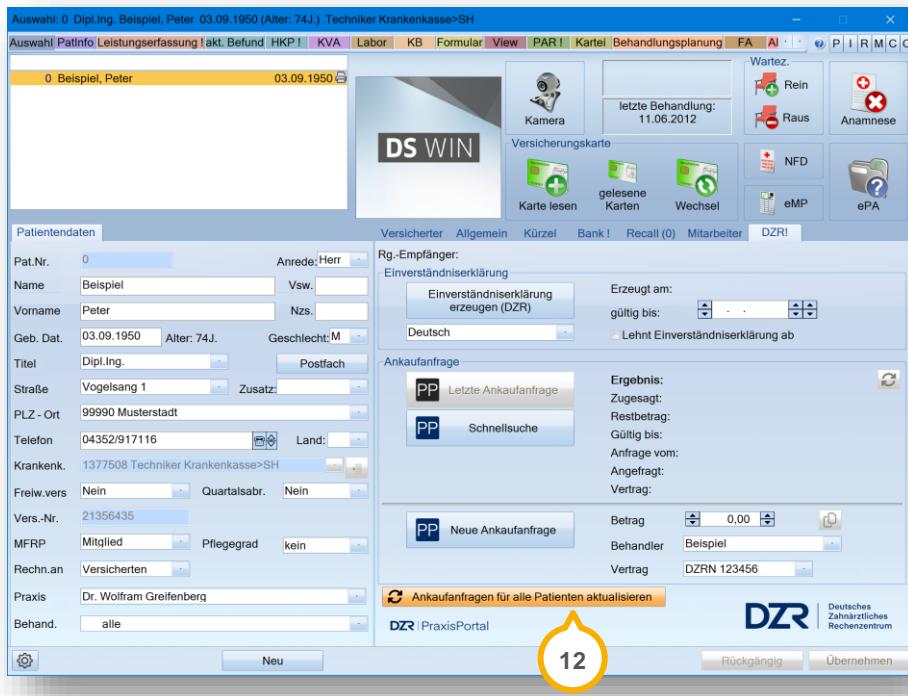

Wenn Sie auf die neue Schaltfläche klicken, wird eine Liste mit den aktualisierten Ankaufanfragen angezeigt.

Ankaufanfragen - Ergebnisse Aktualisieren								
PatNr.	Patient	Angefordert	Status	Zugesagt	Ergebnis / Info	Restbetrag	Gültig bis	Beh. Vertrag
2	[redacted]	5500,00	✓	500,00	Ankauf mit Ausfallschutz	500,00	06.02.2026	1 223344 (DZRS)
3	[redacted]	5500,00	✓	5500,00	Ankauf ohne Ausfallschutz	5500,00	06.02.2026	1 123456 (DZRS)
5	[redacted]	5500,00	✓	5500,00	Ankauf mit Ausfallschutz	5500,00	06.02.2026	1 112233 (DZRS)
4	[redacted]	5500,00	✗	Kein Ankauf				1 123456 (DZRS)
0	Dipl.Ing. Beispiel, Peter	5500,00	✗	Kein Ankauf				1 112233 (DZRS)

Die Liste kann bei Bedarf wie gewohnt ausgedruckt werden.

## 4. e-health

### 4.1 Allgemeine Informationen zu e-health

Allgemeine Informationen zu e-health erhalten Sie über folgende Informationsseiten:

<https://www.dampsoft.de/service/e-health/>

<https://www.dampsoft.de/produkte/produkterweiterungen/telematikinfrastruktur/>

Zusätzlich haben wir für Sie ein Informationsvideo erstellt:

<https://www.youtube.com/watch?v=mXZtzWl8nuA&feature=youtu.be>

Sollten Sie einen eHBA benötigen, können Sie diesen komfortabel über unsere Homepage bei unserem Partner SHC+CARE bestellen:

<https://shc-care.de/produkte/heilberufsausweis-ehba/224/dampsoft2021>

---

#### Hinweis!

---

Entnehmen Sie die detaillierten Voraussetzungen und Handlungsanweisungen aus der Anleitung für die e-health-Anwendungen auf unserer Website unter:

<https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2021/04/dampsoft-anleitung-e-health-1.0.pdf>


---

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über die Neuerungen.

## 4.2 KIM: Große KIM-Mails im Hintergrund senden

Der Versand für KIM-Mails mit großen Anhängen wurde optimiert. KIM-Mails können ab sofort im Hintergrund versendet werden. Zusätzlich können Sie den Fortschritt des KIM-Mail-Versands in der Schnellzugriffleiste überprüfen.

Folgen Sie dem Pfad „Kommunikation/E-Mail“. Wechseln Sie in den Dialog „E-Mail/Einstellungen/Allgemeine Einstellungen“.

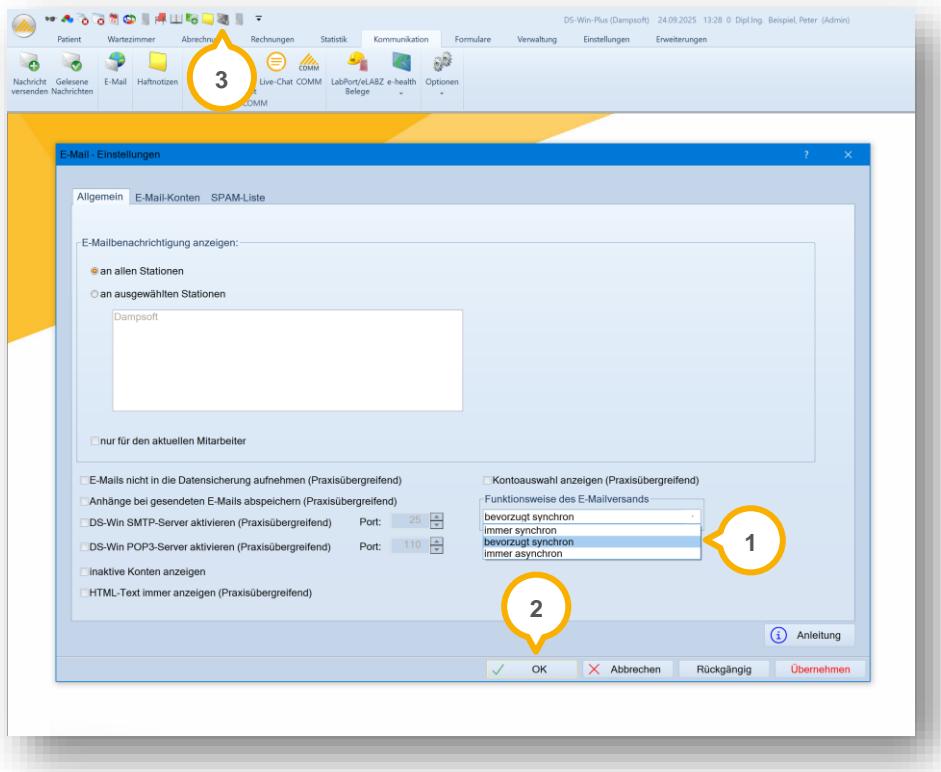

Die neue Auswahl „bevorzugt synchron“ ① ist automatisch ausgewählt.

Wenn Sie die Auswahl beibehalten, können Sie den Dialog nach dem Senden einer KIM-Mail schließen und der Sendevorgang wird im Hintergrund ausgeführt.

Folgende weitere Optionen stehen zur Auswahl:

- immer asynchron: Der Dialog wird nach dem Senden einer KIM-Mail nicht geöffnet. Die KIM-Mail wird ausschließlich im Hintergrund versandt.
- immer synchron: Der Dialog wird nach dem Senden einer KIM-Mail geöffnet. Der Dialog bleibt im Vordergrund geöffnet, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Schließen Sie den Dialog mit >>OK<< ②.

Um den Fortschritt des KIM-Mail-Versands zu überprüfen, kontrollieren Sie die Farbe des Briefumschlag-Symbols ③.

- grau = keine Vorgänge aktiv
- rot = mindestens ein Vorgang fehlerhaft
- gelb = mindestens ein Vorgang aktiv
- grün = alle Vorgänge erfolgreich abgeschlossen

Um weitere Informationen zum Versand zu erhalten, klicken Sie auf das Briefumschlag-Symbol.


## 5. Erweiterungen

### 5.1 DS-Win-BuS/MPG: Neues Siegelgerät MELAG „MELAseal300“ einbinden

Mit diesem Update steht Ihnen das Siegelgerät MELAG „MELAseal 300“ zur Einbindung zur Verfügung.

Folgen Sie dem Pfad „Erweiterungen/MPG/Sterilisationskette“.

Wechseln Sie im Reiter „Verwaltung“ ① in den Reiter „Siegelgeräte“ ②.

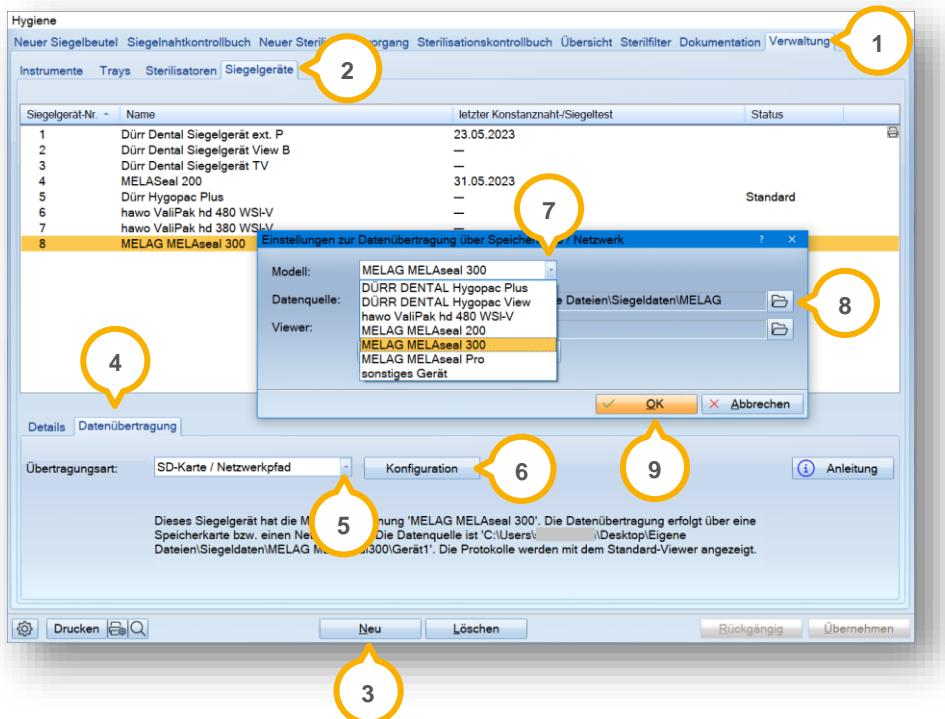

Klicken Sie auf >>Neu<< ③.

Wechseln Sie in den Reiter „Datenübertragung“ ④.

Wählen Sie aus der Auswahlliste ⑤ die Übertragungsart „SD-Karte / Netzwerkpfad“.

Klicken Sie auf >>Konfiguration<< ⑥.

Wählen Sie das Modell aus der Auswahliste ⑦ aus.

Wählen Sie die gewünschte Datenquelle ⑧ aus.

Speichern Sie die Angaben mit >>OK<< ⑨.

Entnehmen Sie das weitere Vorgehen ggf. aus der Anleitung:


[https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2018/04/Einbindung\\_Siegelgeraete.pdf](https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2018/04/Einbindung_Siegelgeraete.pdf)

## 5.2 DS-Win-BuS/MPG: Neuen Sterilisator MELAG „MELAtherm 20“ einbinden

Im DS-Win wurde das neue Reinigungs- und Desinfektionsgerät MELAG „MELAtherm 20“ eingebunden.

Folgen Sie dem Pfad „Erweiterungen/MPG/Sterilisationskette“.

Wechseln Sie im Reiter „Verwaltung“ **1** in den Reiter „Sterilisatoren“ **2**.

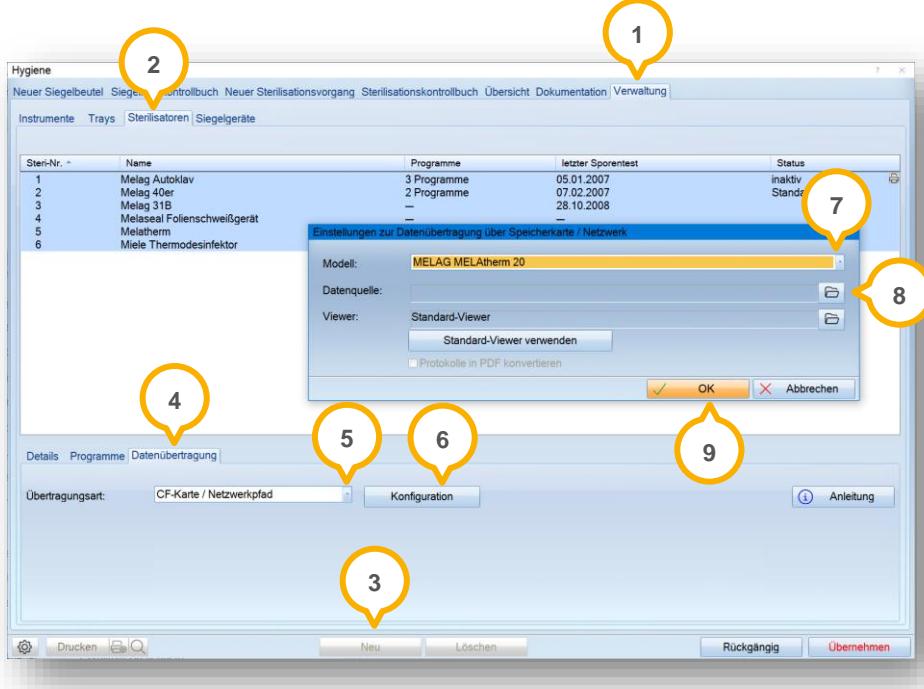

Klicken Sie auf >>Neu<< **3**.

Wechseln Sie in den Reiter „Datenübertragung“ **4**.

Wählen Sie aus der Auswahliste **5** die Übertragungsart „CF-Karte / Netzwerkpfad“.

Klicken Sie auf >>Konfiguration<< **6**.

Wählen Sie das Modell aus der Auswahliste **7** aus.

Wählen Sie die gewünschte Datenquelle **8** aus.

Speichern Sie die Angaben mit >>OK<< **9**.

Entnehmen Sie das weitere Vorgehen ggf. aus der Anleitung:

<https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2023/01/DS-Einbindung-Sterilisator.pdf>

## 5.3 Dr. Flex: Neue Voreinstellung für Benachrichtigungsstatus


Der Dialog „Voreinstellungen für Recall“ wurde um eine Einstellungsmöglichkeit erweitert. Die neue Voreinstellung ist mit diesem Update automatisch gesetzt. Durch die Voreinstellung wird der Benachrichtigungsstatus automatisch gesetzt, sobald ein Termin mit Dr. Flex im Terminbuch gebucht wird.

### Hinweis!

Die Einstellung greift ausschließlich, wenn ein Behandler in der Patientenauswahl ausgewählt ist. Ist bei Behandler „alle“ eingetragen, erhalten Sie eine Hinweismeldung.

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Verwaltung/Recall“.

Wechseln Sie über das Einstellungssymbol in die Voreinstellungen.

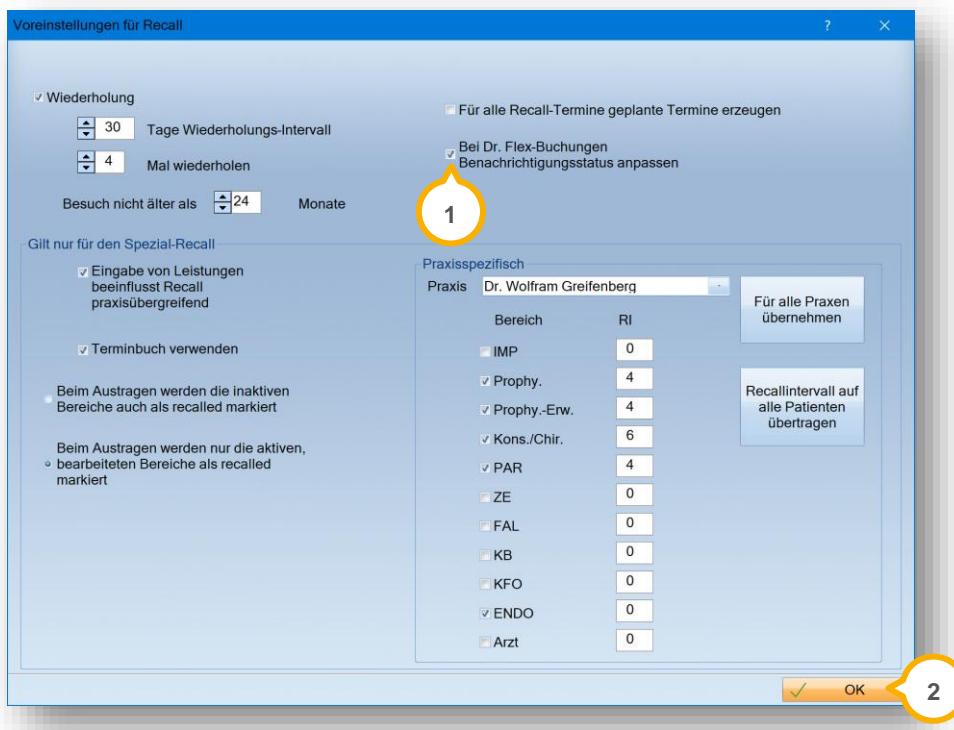

Die neue Voreinstellung finden Sie im Bereich ①.

**Tipp:** Wenn Sie keine Änderung des Benachrichtigungsstatus wünschen, sobald ein Termin mit Dr. Flex gebucht wurde, können Sie das Häkchen für die Voreinstellung entfernen.

Speichern Sie die Angaben mit >>OK<< ②.

## 5.4 DS-Win-MED: Neues Kodierungssystem für Gendiagnostik

Gemäß den Vorgaben des Bewertungsausschusses wurde für die Abrechnung von human- und tumorgenetischen Leistungen ein neues Kodierungssystem eingeführt.

Seit dem **1. Juli 2025** müssen für die betreffenden Leistungen die Gensymbole des HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) verwendet werden.

### **Hinweis!**

**Die bisher verwendeten OMIM-Kodierungen werden vollständig durch die HGNC-Gensymbole ersetzt.  
Abrechnungen der Leistungen, die vor dem 1. Juli 2025 mit der OMIM-Kodierung gekennzeichnet wurden, werden dennoch berücksichtigt.**

## 5.5 Athena: Datum der Einverständniserklärungen wird übernommen

Das Datum der Einverständniserklärung für verschiedene Abrechnungsbüros wird zukünftig von Athena in das DS-Win übertragen. Wenn ein Patient seine Einverständniserklärung über Athena angibt, wird das Datum dieser Einverständniserklärung automatisch an das DS-Win übertragen und im entsprechenden Reiter in der Patientenkartei dokumentiert.



**DAMPSOFT**

DAMPSOFT GmbH  
Vogelsang 1 / 24351 Damp

T 04352 9171-16 / F 04352 9171-90  
[info@dampsoft.de](mailto:info@dampsoft.de) / [www.dampsoft.de](http://www.dampsoft.de)